


RAPPORT DE TEST BANC DE CONTROLE MATITEST

N° de série du banc : EVO N°4 04/2018

Identification inspecteur

Société	MATISEC	Signature et cachet Yoan LEMOINE 
Nom	LEMOINE Yoan	
Fonction	Matisec SAV	
Date	07/08/2025 08:40 n° 5	

Identification équipement

Type d'appareil	MAT AIR DOUBLE ENTREE
Numéro de série	CMA5689
Numéro de détenteur	
Numéro de régulateur	45533
Numéro de masque	
Nature	S
Date de fabrication	nov.-21

Contrôle visuel de l'équipement

CONTROLE VISUEL COMPLET

Étanchéité circuit (HP)

CONFORME

Valeur début test	263,26 b	262,82 b	Valeur fin test
Pente fuite référence	20,00 b/min	2,60 b/min	Pente de fuite mesurée

Contrôle dynamique

Valeur BP statique

CONFORME

Seuil de référence	Valeur mesurée	Tolérance basse	Tolérance haute
3,00 b	4,00 b	1,00 b	5,00 b

Valeur BP dynamique

CONFORME

Cadence 1			
Fréquence respiratoire	40,00 bpm	2,50 L	Volume respiratoire
Seuil de référence (min)	0,50 mb	2,20 mb	Valeur mesurée (min)
Seuil de référence (max)	10,00 mb	8,60 mb	Valeur mesurée (max)
Cadence 2			
Fréquence respiratoire	40,00 bpm	2,50 L	Volume respiratoire
Seuil de référence (min)	0,50 mb	2,20 mb	Valeur mesurée (min)
Seuil de référence (max)	10,00 mb	8,60 mb	Valeur mesurée (max)

Valeur MP dynamique

CONFORME

Cadence 1			
Seuil de référence (min)	4,50 b	5,20 b	Valeur mesurée (min)
Cadence 2			
Seuil de référence (min)	4,50 b	5,20 b	Valeur mesurée (min)


Débit du By-Pass

CONFORME


Seuil de référence	Valeur mesurée
60,00 L/min	364,00 L/min

Courbes respiratoires

Courbe 1 : 40,00 bpm X 2,50 L

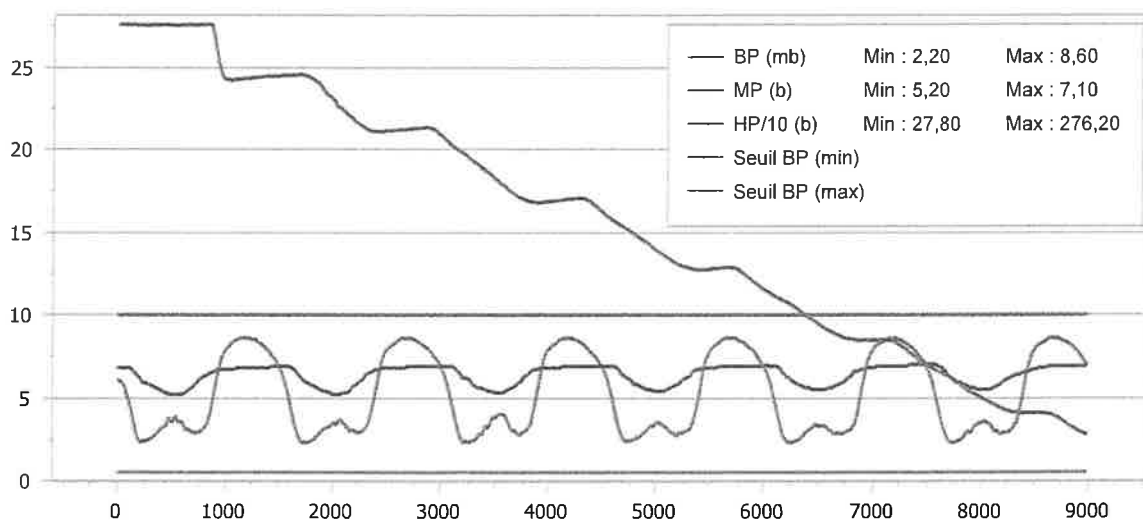

Courbe 2 : 40,00 bpm X 2,50 L

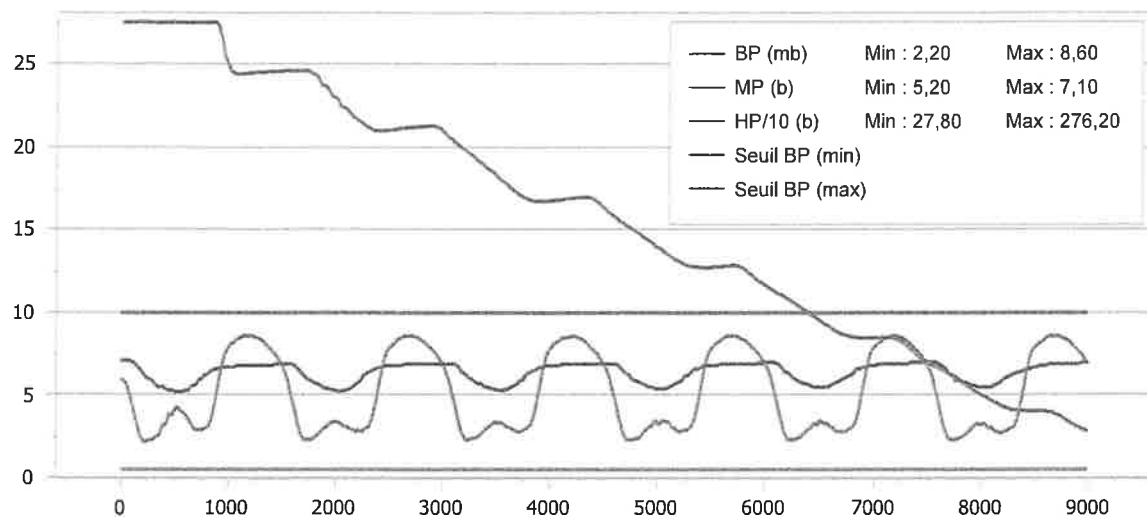

Synthèse et résultat du contrôle

CONFORME