

Identification de l'équipement		Date du contrôle	2026-03-12
Numéro série	17665	Nom de l'opérateur	DBRAIT
Numéro détenteur	DI17665	Fonction de l'opérateur	TECHNICIEN SAV
Numéro régulateur	RC9647	Date de fabrication	09/07
Numéro masque	M63619	Type d'appareil	CFC
Numéro banc	2	Date de calibration du banc	2026-02-06

Contrôle visuel

Contrôle visuel compl. correct

Étanchéité et test ouverture soupape masque

Références				Mesures		
Seuil de référence 1ère inspiration	0.0	mB		Mesure 1ère inspiration	0.0	mB
Seuil de référence dépression	-12.0	mB		Seuil de mesure dépression	-10.0	mB
Pente de fuite référence	6.0	mB/mn		Pente de fuite mesurée	2.5	mB/mn
Seuil pression expiration maxi	8.0	mB		Seuil pression expiration mesuré	5.9	mB
Seuil pression expiration mini	4.5	mB				
Résultat	Conforme					

Contrôle MP détenteur

Références				Mesures		
Valeur MP référence détenteur	7.0	B		Valeur MP détenteur mesurée	6.64	B
Tolérance basse	6.0	B		Valeur stabilisation MP détenteur	6.6	B
Tolérance haute	8.0	B		Valeur après temps de mesure	6.67	B
Variation MP référence détenteur	0.3	B/mn		Variation MP détenteur mesurée	0.1	mB/mn
Résultat	Conforme					

Contrôle manomètre

Références				Mesures		
1er point de mesure manomètre	171.6	B				
Tolérance basse 1er point mesure	161.6	B		Saisie 1er point de mesure manomètre	172.0	B
Tolérance haute 1er point mesure	181.6	B				
2ème point de mesure manomètre	171.8	B				
Tolérance basse 2ème point mesure	161.8	B		Saisie 2ème point de mesure manomètre	173.0	B
Tolérance haute 2ème point mesure	181.8	B				
3ème point de mesure manomètre	97.6	B				
Tolérance basse 3ème point mesure	92.6	B		Saisie 3ème point de mesure manomètre	100.0	B
Tolérance haute 3ème point mesure	102.6	B				
Résultat	Conforme					

Contrôle sifflet

Références				Mesures		
Seuil de référence sifflet	55	B				
Tolérance basse sifflet	50	B		Valeur mesurée sifflet	53.5	B
Tolérance haute sifflet	60	B				
Résultat	Conforme					

Soupape détenteur

Références				Mesures		
Seuil de référence soupape	9	B				
Tolérance basse soupape	9	B		Valeur mesurée soupape	9.1	B
Tolérance haute soupape	13	B				
Résultat	Conforme					

Test étanchéité circuit

Références				Mesures		
				Valeur HP mesurée (début)	163.33	B
Pente de référence étanchéité HP	20.0	B/mn		Valeur HP mesurée (fin)	162.69	B
				Pente calculée étanchéité circuit	3.8	B/mn
Résultat	Conforme					

Contrôle dynamique de l'appareil – BP statique

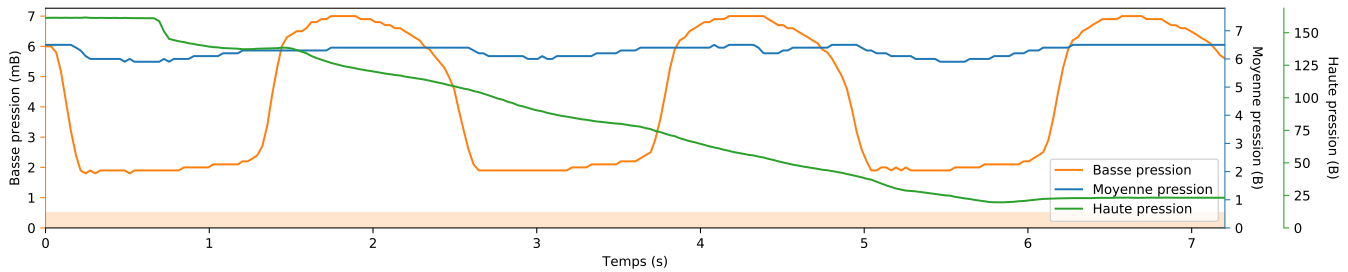
Références				Mesures		
Valeur BP statique référence	3.0	mB				
Tolérance basse BP statique	2.0	mB		Valeur BP statique référence	3.2	mB
Tolérance haute BP statique	4.0	mB				
Résultat	Conforme					

Contrôle débit du bypass

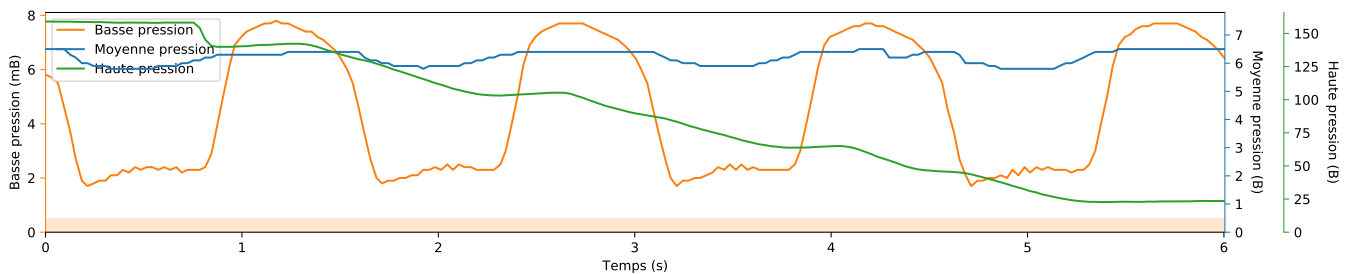
Références			Mesures		
Seuil de référence débit bypass	60	L/mn	Valeur mesurée débit bypass	232	L/mn
Résultat	Conforme				

Contrôle dynamique de l'appareil – Cadence 1

Références			Mesures		
Fréquence respiratoire	25	cps/mn			
Volume respiratoire	2.00	L			
Seuil mini BP	0.5	mB	Valeur mini BP mesurée	1.8	mB
Seuil maxi BP	10.0	mB	Valeur maxi BP mesurée	7.0	mB
Résultat	Conforme				

**Contrôle dynamique de l'appareil – Cadence 2**

Références			Mesures		
Fréquence respiratoire	40	cps/mn			
Volume respiratoire	2.50	L			
Seuil mini BP	0.5	mB	Valeur mini BP mesurée	1.7	mB
Seuil maxi BP	10.0	mB	Valeur maxi BP mesurée	7.8	mB
Résultat	Conforme				

**Contrôle dynamique de l'appareil – MP**

Références			Mesures		
Seuil mini MP dynamique cadence 1	4.5	B	Valeur mini MP mesurée cadence 1	5.9	B
Seuil mini MP dynamique cadence 2	4.5	B	Valeur mini MP mesurée cadence 2	5.7	B
Résultat	Conforme				

Synthèse et résultat du contrôle**Conforme****Signature du contrôleur**