


RAPPORT DE TEST BANC DE CONTROLE MATITEST

N° de série du banc : EVO N°11(03/2019)

Identification inspecteur

Société	MATISEC	Signature et cachet	
Nom	VISTALLI Sylvain	Sylvain VISTALLI	
Fonction	Opérateur fabrication MATISEC		
Date	24/04/2026 10:45	n° 15	

Identification équipement

Type d'appareil	TRIPLAIR NG MARINE
Numéro de série	TRNG3501
Numéro de détendeur	2201160
Numéro de régulateur	58417
Numéro de masque	M86932
Nature	S
Date de fabrication	avr.-26

Contrôle visuel de l'équipement

visuel ok

Étanchéité et test ouverture soupape masque

CONFORME

	Références	Mesures
1re inspiration	0,00 mb	0,00 mb
Dépression	-10,00 mb	-8,00 mb
Pente de fuite	1,00 mb/min	1,00 mb/min
Pression expiration (min)	4,50 mb	5,30 mb
Pression expiration (max)	7,00 mb	

Détendeur (MP)

CONFORME

Seuil de référence	7,00 b	7,02 b	Seuil de stabilisation
Tolérance basse	6,00 b	8,00 b	Tolérance haute
Valeur début test	7,00 b	7,02 b	Valeur fin test
Pente fuite référence	1,50 b/min	0,00 b/min	Pente de fuite mesurée

Manomètre

CONFORME

Mesures	Tolérance basse	Tolérance haute	Saisie opérateur
319,50 b	309,50 b	329,50 b	320,00 b
199,70 b	189,70 b	209,70 b	200,00 b
98,80 b	93,80 b	103,80 b	100,00 b

Sifflet

CONFORME

Seuil de référence	Valeur mesurée	Tolérance basse	Tolérance haute
55,00 b	56,20 b	50,00 b	60,00 b

Soupape de détendeur

CONFORME

Seuil de référence	Valeur mesurée	Tolérance basse	Tolérance haute
9,00 b	11,80 b	9,00 b	13,00 b

Étanchéité circuit (HP)

CONFORME

Valeur début test	311,71 b	312,00 b	Valeur fin test
Pente fuite référence	20,00 b/min	1,70 b/min	Pente de fuite mesurée

Contrôle dynamique

Valeur BP statique

CONFORME

Seuil de référence	Valeur mesurée	Tolérance basse	Tolérance haute
3,00 b	2,50 b	2,00 b	4,00 b

Valeur BP dynamique

CONFORME

Cadence 1			
Fréquence respiratoire	40,00 bpm	2,50 L	Volume respiratoire
Seuil de référence (min)	0,50 mb	1,10 mb	Valeur mesurée (min)
Seuil de référence (max)	10,00 mb	6,50 mb	Valeur mesurée (max)

Valeur MP dynamique

CONFORME

Cadence 1			
Seuil de référence (min)	4,50 b	6,10 b	Valeur mesurée (min)


Débit du By-Pass

CONFORME

Seuil de référence	Valeur mesurée
60,00 L/min	543,00 L/min

Courbes respiratoires

Courbe 1 : 40,00 bpm X 2,50 L

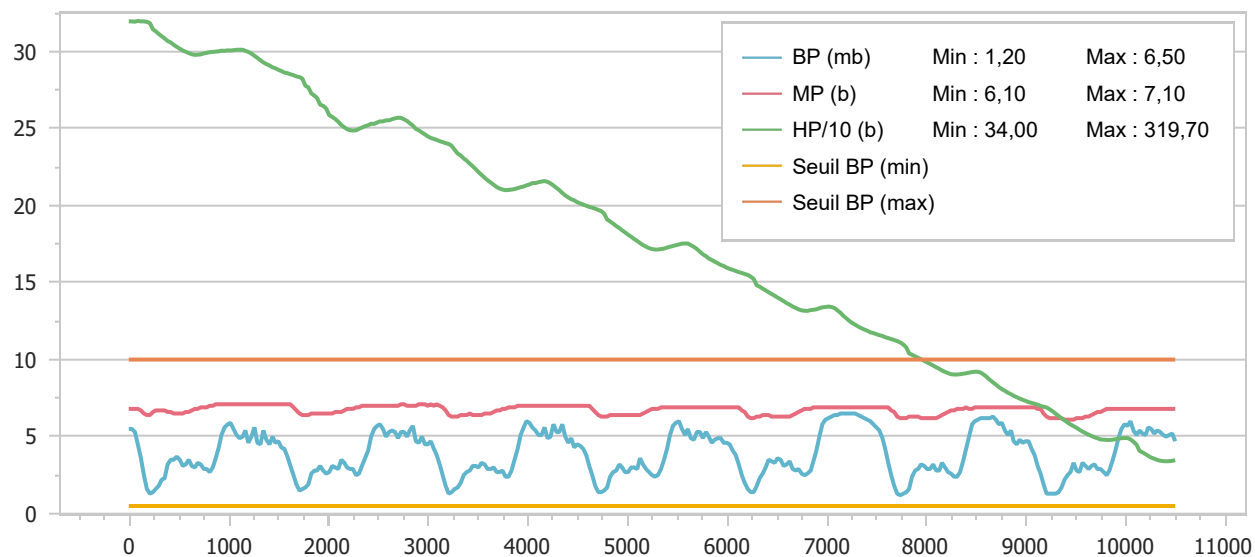

Synthèse et résultat du contrôle

CONFORME