


RAPPORT DE TEST BANC DE CONTROLE MATITEST

N° de série du banc : EVO N°11(03/2019)

Identification inspecteur

Société	MATISEC	Signature et cachet	
Nom	VISTALLI Sylvain	Sylvain VISTALLI	
Fonction	Opérateur fabrication MATISEC		
Date	23/04/2026 13:26	n° 72	

Identification équipement

Type d'appareil	TOTAL 3
Numéro de série	M86909
Numéro de détendeur	
Numéro de régulateur	
Numéro de masque	
Nature	S
Date de fabrication	avr.-26

Contrôle visuel de l'équipement

visuel ok

Étanchéité et test ouverture soupape masque

CONFORME

	Références	Mesures
1re inspiration	0,00 mb	0,00 mb
Dépression	-10,00 mb	-8,00 mb
Pente de fuite	1,00 mb/min	1,00 mb/min
Pression expiration (min)	4,50 mb	5,50 mb
Pression expiration (max)	7,00 mb	

Contrôle dynamique

Valeur BP statique

CONFORME

Seuil de référence	Valeur mesurée	Tolérance basse	Tolérance haute
3,00 b	3,20 b	2,00 b	4,00 b

Valeur BP dynamique

CONFORME

Cadence 1			
Fréquence respiratoire	40,00 bpm	2,50 L	Volume respiratoire
Seuil de référence (min)	0,50 mb	1,80 mb	Valeur mesurée (min)
Seuil de référence (max)	10,00 mb	6,90 mb	Valeur mesurée (max)

Valeur MP dynamique

CONFORME

Cadence 1			
Seuil de référence (min)	4,50 b	6,20 b	Valeur mesurée (min)


Débit du By-Pass

CONFORME

Seuil de référence	Valeur mesurée
60,00 L/min	472,00 L/min

Courbes respiratoires

Courbe 1 : 40,00 bpm X 2,50 L

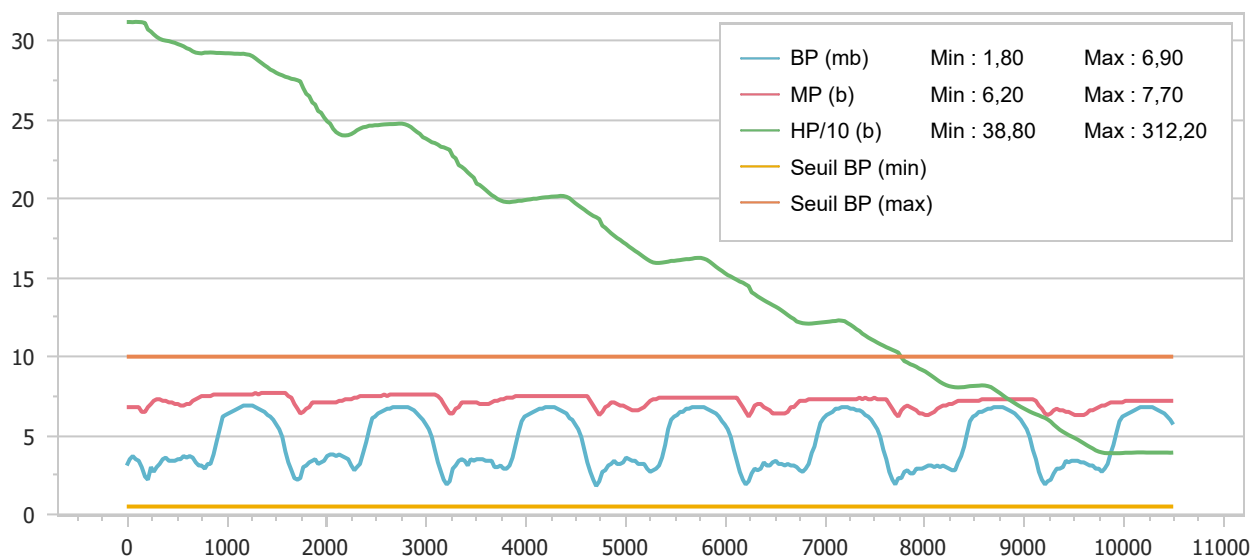

Synthèse et résultat du contrôle

CONFORME