


RAPPORT DE TEST BANC DE CONTROLE MATITEST

N° de série du banc : EVO N°51

Identification inspecteur

Société	MATISEC	Signature et cachet	
Nom	MULLER Jimmy	Jimmy MULLER	
Fonction	Matisec SAV		
Date	06/11/2025 09:35	n° 17	

Identification équipement

Type d'appareil	GPAL INCURVE
Numéro de série	CIN22684
Numéro de détendeur	2224128
Numéro de régulateur	50837
Numéro de masque	M72659
Nature	S
Date de fabrication	oct.-23

Contrôle visuel de l'équipement

controle visuel ok

Étanchéité et test ouverture soupape masque

CONFORME

	Références	Mesures
1re inspiration	0,00 mb	0,00 mb
Dépression	-12,00 mb	-10,00 mb
Pente de fuite	6,00 mb/min	5,70 mb/min
Pression expiration (min)	4,50 mb	5,80 mb
Pression expiration (max)	8,00 mb	

Détendeur (MP)

CONFORME

Seuil de référence	7,00 b	6,65 b	Seuil de stabilisation
Tolérance basse	6,00 b	8,00 b	Tolérance haute
Valeur début test	6,60 b	6,63 b	Valeur fin test
Pente fuite référence	1,50 b/min	0,10 b/min	Pente de fuite mesurée

Manomètre

CONFORME

Mesures	Tolérance basse	Tolérance haute	Saisie opérateur
287,20 b	277,20 b	297,20 b	290,00 b
199,70 b	189,70 b	209,70 b	200,00 b
99,20 b	94,20 b	104,20 b	100,00 b

Sifflet

CONFORME

Seuil de référence	Valeur mesurée	Tolérance basse	Tolérance haute
55,00 b	57,50 b	50,00 b	60,00 b

Soupape de détendeur

CONFORME

Seuil de référence	Valeur mesurée	Tolérance basse	Tolérance haute
9,00 b	11,30 b	9,00 b	13,00 b

Étanchéité circuit (HP)

CONFORME

Valeur début test	277,35 b	277,11 b	Valeur fin test
Pente fuite référence	20,00 b/min	1,40 b/min	Pente de fuite mesurée

Contrôle dynamique

Valeur BP statique

CONFORME

Seuil de référence	Valeur mesurée	Tolérance basse	Tolérance haute
3,00 b	3,60 b	2,00 b	4,00 b

Valeur BP dynamique

CONFORME

Cadence 1			
Fréquence respiratoire	40,00 bpm	2,50 L	Volume respiratoire
Seuil de référence (min)	0,00 mb	1,70 mb	Valeur mesurée (min)
Seuil de référence (max)	10,00 mb	8,80 mb	Valeur mesurée (max)

Valeur MP dynamique

CONFORME

Cadence 1			
Seuil de référence (min)	4,50 b	5,50 b	Valeur mesurée (min)


Débit du By-Pass

CONFORME

Seuil de référence	Valeur mesurée
60,00 L/min	165,00 L/min

Courbes respiratoires

Courbe 1 : 40,00 bpm X 2,50 L

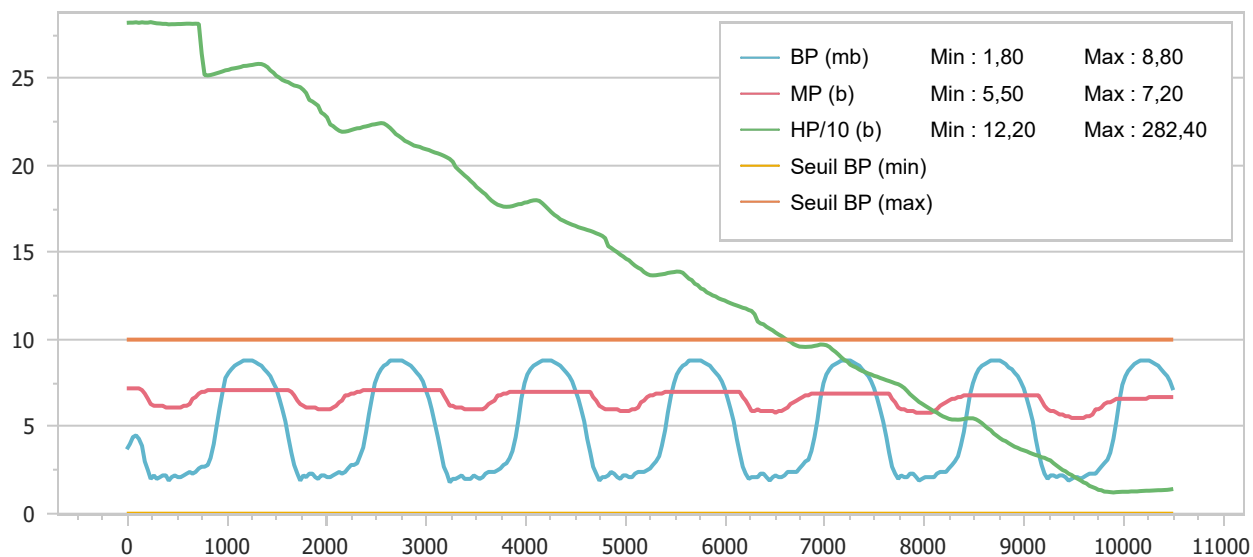

Synthèse et résultat du contrôle

CONFORME