



FICHE DE CONTRÔLE ARI

N° d'essai :

Effectué le :

01/12/2025

Nom:

GINET

Table de paramètres:


3

Fonction:

Technicien S

	Type d'appareil : Numéro de Chassis: Numéro de régulateur: Numéro de détendeur: Numéro de masque:	GPAL IS LEGER GLI20939-SAL029 RC46633 DIS2034388 T3F1/49113	Nature: Fabriqué en:	S nov-21
Etanchéité masque	Valeur début test: Valeur fin test: Résultat: Correct	-6.9 mb -6.9 mb Remarques: SRARIMASPO-SAL005	Pente fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	6 mb/mn -0 mb/mn
Manomètre	Consignes Mesures Résultat: Correct	Tolérance haute Tolérance basse Saisie opérateur 237 b 10 b 130 b 70 b 132 b 73 b 10 b 5 b 10 b 5 b 235 b 132 b 71 b		
Moyenne pression	Seuil référence: Valeur MP+10s: Résultat: Correct	7 b 7.4 b	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	1 b 1 b
Etanchéité détendeur	Valeur MP+20s: Résultat: Correct	7.5 b Remarque: SRARIDOSLEGER-SAL029	Pente de fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	1.5 b/mn 0.3 b/mn
Sifflet manuel	Seuil Référence: Valeur mesurée: Résultat: Correct	55 b 57 b Remarque: SRARIDOSLEGER-SAL029	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	5 b 5 b
Soupape de sécurité	Seuil Référence: Valeur mesurée: Résultat: Correct	9 b 12.3 b Remarque: SRARIDOSLEGER-SAL029	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	0 b 4 b

Controle				
dynamique	Fréquence respiratoire:	40 Cps/mn	Volume:	2.5 Litres
	Valeur BP stat mesurée:	4 mb	Tolérance basse référen:	2 mb
			Tolérance haute référen:	4 mb
Résultat BP:	ValeurminiMP mesurée:	5.7 b	Mini MP Référence:	4.5 b
Correct	ValeurmaxBP mesurée:	8 mb	SHR Référence:	10 mb
	ValeurminiBP mesurée:	3.7 mb	SBR Référence:	0.5 mb
Résultat MP:	Remarque :			
Correct				

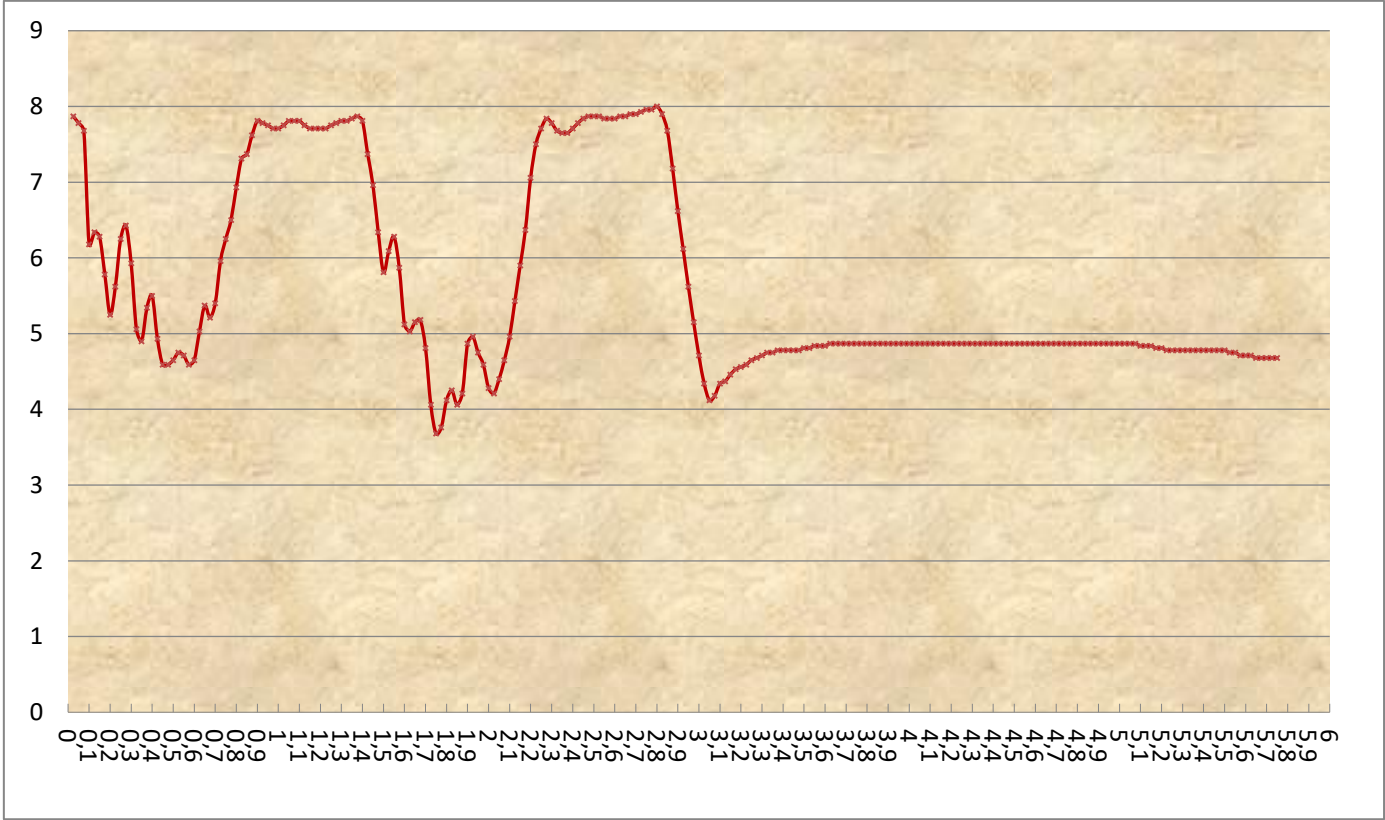

Visa: