



# FICHE DE CONTRÔLE ARI

N° d'essai :

Effectué le :

11/12/2025

Nom:

GINET

Table de paramètres:


5

Fonction:

Technicien S

	Type d'appareil : Numéro de Chassis: Numéro de régulateur: Numéro de détendeur: Numéro de masque:	GPAL II SRP126-SAL022 RC5869 D20199 T3C/SRP417	Nature: Fabriqué en:	S ????																				
<b>Etanchéité masque</b>  Résultat: <b>Correct</b>	Valeur début test: Valeur fin test: Remarques:	-10.1 mb -10.1 mb SRARIMASDRAGE-SAL208	Pente fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	6 mb/mn -0 mb/mn																				
<b>Manomètre</b>  Résultat: <b>Correct</b>	Consignes  Mesures  Remarques:	<table><tr><td></td><td></td><td>Tolérance haute</td><td>Tolérance basse</td><td>Saisie opérateur</td></tr><tr><td></td><td></td><td>176 b</td><td>10 b</td><td>10 b</td></tr><tr><td>130 b</td><td></td><td>131 b</td><td>10 b</td><td>10 b</td></tr><tr><td>70 b</td><td></td><td>71 b</td><td>5 b</td><td>5 b</td></tr></table> SRARIDOSARI-SAL022			Tolérance haute	Tolérance basse	Saisie opérateur			176 b	10 b	10 b	130 b		131 b	10 b	10 b	70 b		71 b	5 b	5 b		179 b 133 b 72 b
		Tolérance haute	Tolérance basse	Saisie opérateur																				
		176 b	10 b	10 b																				
130 b		131 b	10 b	10 b																				
70 b		71 b	5 b	5 b																				
<b>Moyenne pression</b>  Résultat: <b>Correct</b>	Seuil référence:  Valeur MP+10s:	7 b  7.3 b	Tolérance basse référen:  Tolérance haute référen:	1 b  1 b																				
<b>Etanchéité détendeur</b>  Résultat: <b>Correct</b>	Valeur MP+20s:  Remarque:	7.4 b  SRARIDOSARI-SAL022	Pente de fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	1.5 b/mn 0.3 b/mn																				
<b>Sifflet manuel</b>  Résultat: <b>Correct</b>	Seuil Référence: Valeur mesurée:  Remarque:	55 b 56 b  SRARIDOSARI-SAL022	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	5 b 5 b																				
<b>Soupape de sécurité</b>  Résultat: <b>Correct</b>	Seuil Référence: Valeur mesurée:  Remarque:	9 b 11.2 b  SRARIDOSARI-SAL022	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	0 b 4 b																				

<b>Controle dynamique</b>	<i>Fréquence respiratoire:</i>	40 Cps/mn	<i>Volume:</i>	2.5 Litres
	<i>Valeur BP stat mesurée:</i>	4.2 mb	<i>Tolérance basse référen:</i>	1 mb
			<i>Tolérance haute référen:</i>	5 mb
Résultat BP:	<i>ValeurminiMP mesurée:</i>	6.3 b	<i>Mini MP Référence:</i>	4.5 b
<b>Correct</b>	<i>ValeurmaxBP mesurée:</i>	7.55625 mb	<i>SHR Référence:</i>	10 mb
	<i>ValeurminiBP mesurée:</i>	2.775 mb	<i>SBR Référence:</i>	0.5 mb
Résultat MP:	<i>Remarque :</i>			
<b>Correct</b>				

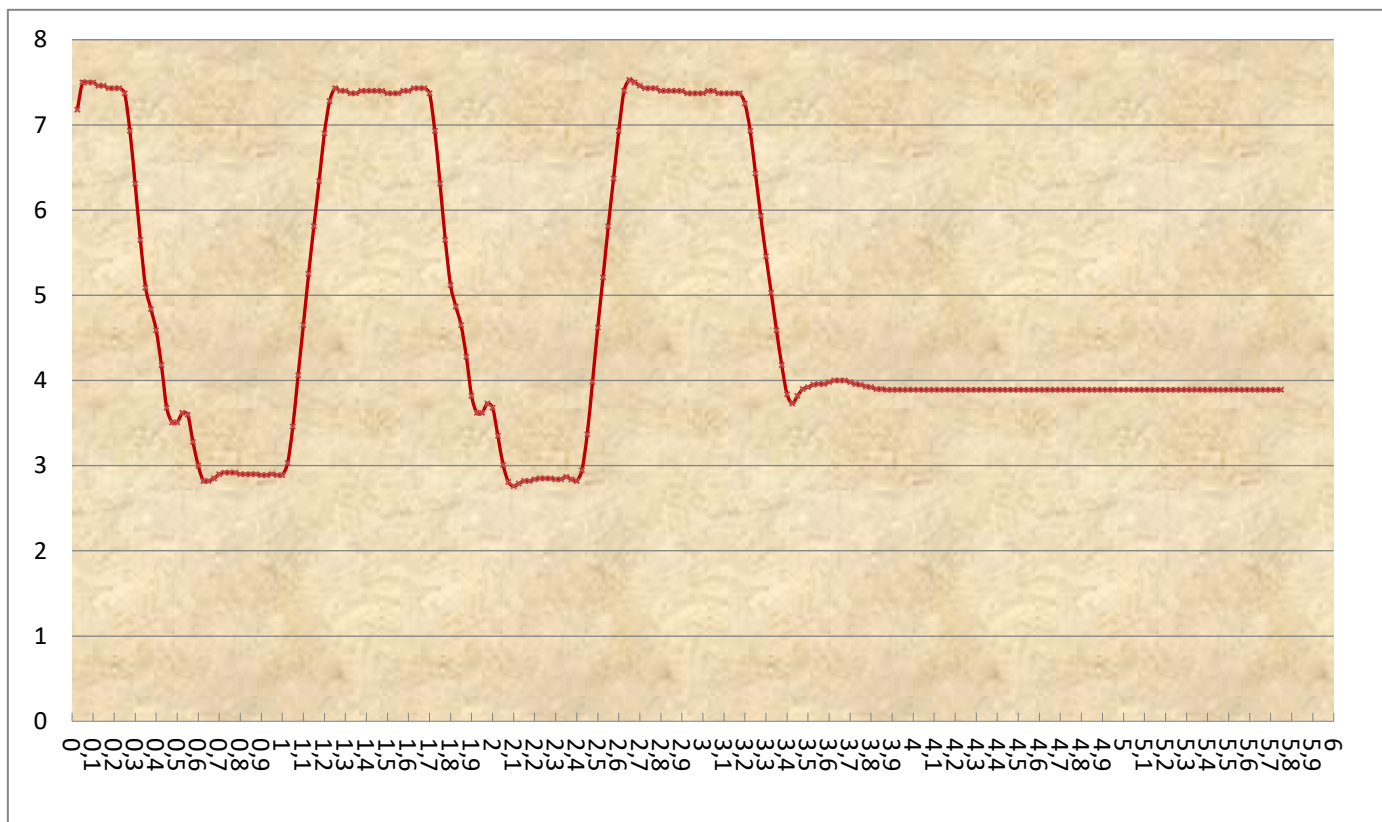

**Visa:**

