



FICHE DE CONTRÔLE ARI

N° d'essai :

Effectué le :

24/10/2025

Nom:

GINET

Table de paramètres:


3

Fonction:

Technicien S

	Type d'appareil : Numéro de Chassis: Numéro de régulateur: Numéro de détendeur: Numéro de masque:	GPAL INCURVE CIN21612-SAL045 RC45127 DIS2125120 T3F1/49799	Nature: Fabriqué en:	S mars-22
Etanchéité masque	Valeur début test: Valeur fin test: Résultat: Correct	-10 mb -9.2 mb Remarques: SRARIMASDRAGE-SAL364	Pente fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	6 mb/mn 4.8 mb/mn
Manomètre	Consignes Mesures Résultat: Correct	Tolérance haute Tolérance basse Saisie opérateur 216 b 10 b 10 b 215 b 130 b 131 b 10 b 131 b 70 b 68 b 5 b 5 b 70 b Remarques: SRARIDOSLEGER-SAL045		
Moyenne pression	Seuil référence: Valeur MP+10s: Résultat: Correct	7 b 7.3 b	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	1 b 1 b
Etanchéité détendeur	Valeur MP+20s: Résultat: Correct	7.3 b Remarque: SRARIDOSLEGER-SAL045	Pente de fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	1.5 b/mn 0 b/mn
Sifflet manuel	Seuil Référence: Valeur mesurée: Résultat: Correct	55 b 54 b Remarque: SRARIDOSLEGER-SAL045	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	5 b 5 b
Soupape de sécurité	Seuil Référence: Valeur mesurée: Résultat: Correct	9 b 12.3 b Remarque: SRARIDOSLEGER-SAL045	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	0 b 4 b

Controle dynamique	<i>Fréquence respiratoire:</i>	40 Cps/mn	<i>Volume:</i>	2.5 Litres
	<i>Valeur BP stat mesurée:</i>	2.5 mb	<i>Tolérance basse référen:</i>	2 mb
			<i>Tolérance haute référen:</i>	4 mb
Résultat BP:	<i>ValeurminiMP mesurée:</i>	6 b	<i>Mini MP Référence:</i>	4.5 b
Correct	<i>ValeurmaxBP mesurée:</i>	8.23125 mb	<i>SHR Référence:</i>	10 mb
	<i>ValeurminiBP mesurée:</i>	2.3 mb	<i>SBR Référence:</i>	0.5 mb
Résultat MP:	<i>Remarque :</i>			
Correct				

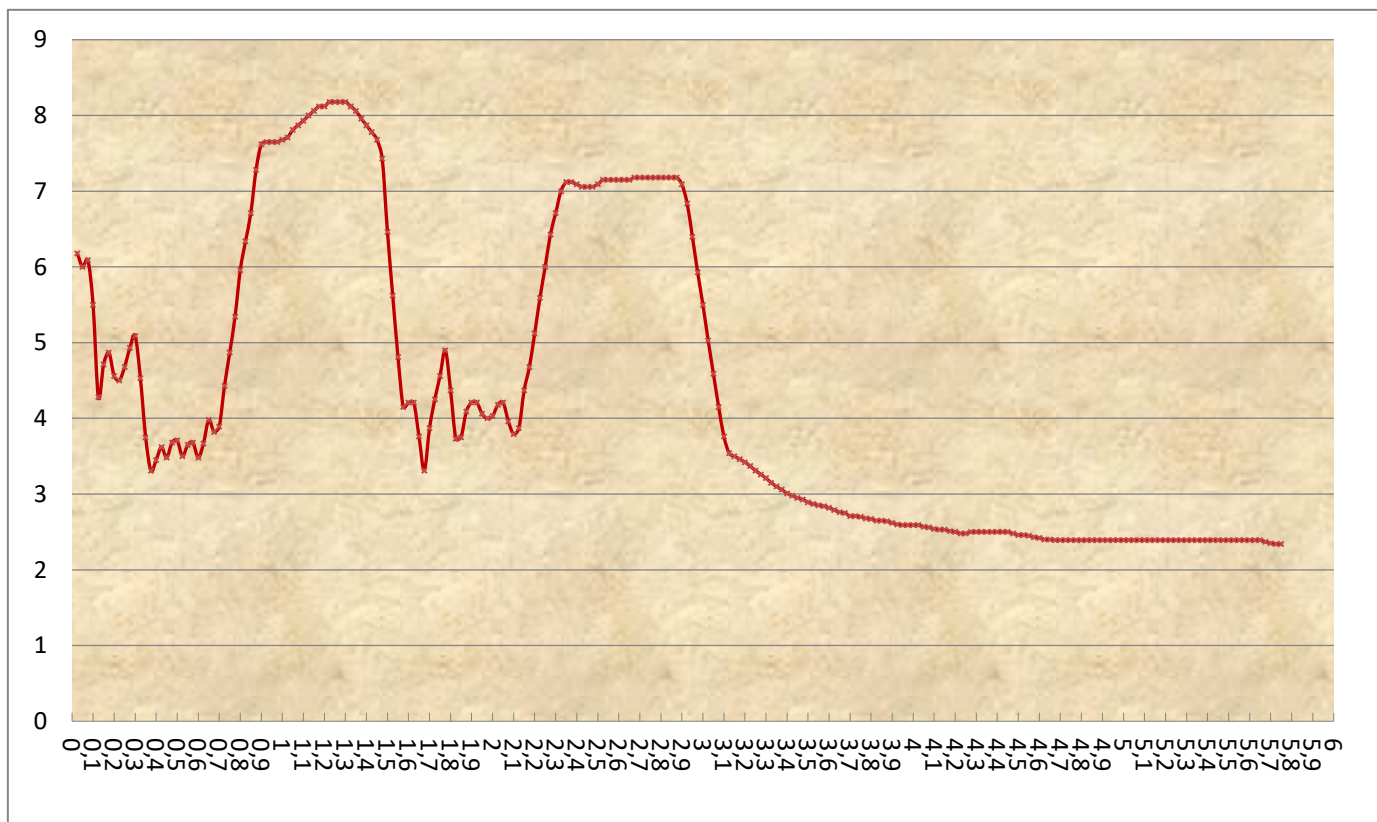

Visa:

