



FICHE DE CONTRÔLE ARI

N° d'essai :

Effectué le :

25/11/2025

Nom:

GINET

Table de paramètres:


5

Fonction:

Technicien S

	Type d'appareil : Numéro de Chassis: Numéro de régulateur: Numéro de détendeur: Numéro de masque:	GPAL II C11841-SAL008 RC34694 D15084 T3C/73611	Nature: Fabriqué en:	S févr-25																								
Etanchéité masque Résultat: Correct	Valeur début test: Valeur fin test: Remarques:	-6.9 mb -6.9 mb SRARIMASDRAGE-SAL404	Pente fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	6 mb/mn -0 mb/mn																								
Manomètre Résultat: Correct	Consignes Mesures Remarques:	<table><thead><tr><th></th><th>Tolérance haute</th><th>Tolérance basse</th><th>Saisie opérateur</th></tr></thead><tbody><tr><td>196 b</td><td>10 b</td><td>10 b</td><td>195 b</td></tr><tr><td>130 b</td><td>10 b</td><td>10 b</td><td>129 b</td></tr><tr><td>70 b</td><td>5 b</td><td>5 b</td><td>72 b</td></tr><tr><td>127 b</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>72 b</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> SRARIDOS3B48C-SAL008		Tolérance haute	Tolérance basse	Saisie opérateur	196 b	10 b	10 b	195 b	130 b	10 b	10 b	129 b	70 b	5 b	5 b	72 b	127 b				72 b					
	Tolérance haute	Tolérance basse	Saisie opérateur																									
196 b	10 b	10 b	195 b																									
130 b	10 b	10 b	129 b																									
70 b	5 b	5 b	72 b																									
127 b																												
72 b																												
Moyenne pression Résultat: Correct	Seuil référence: Valeur MP+10s:	7 b 7.3 b	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	1 b 1 b																								
Etanchéité détendeur Résultat: Correct	Valeur MP+20s: Remarque:	7.3 b SRARIDOS3B48C-SAL008	Pente de fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	1.5 b/mn 0 b/mn																								
Sifflet manuel Résultat: Correct	Seuil Référence: Valeur mesurée: Remarque:	55 b 52 b SRARIDOS3B48C-SAL008	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	5 b 5 b																								
Soupape de sécurité Résultat: Correct	Seuil Référence: Valeur mesurée: Remarque:	9 b 11.6 b SRARIDOS3B48C-SAL008	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	0 b 4 b																								

Controle dynamique				
	Fréquence respiratoire:	40 Cps/mn	Volume:	2.5 Litres
	Valeur BP stat mesurée:	4 mb	Tolérance basse référen:	1 mb
			Tolérance haute référen:	5 mb
Résultat BP:	ValeurminiMP mesurée:	6.4 b	Mini MP Référence:	4.5 b
Correct	ValeurmaxBP mesurée:	8.0625 mb	SHR Référence:	10 mb
	ValeurminiBP mesurée:	4 mb	SBR Référence:	0.5 mb
Résultat MP:	Remarque :			
Correct				

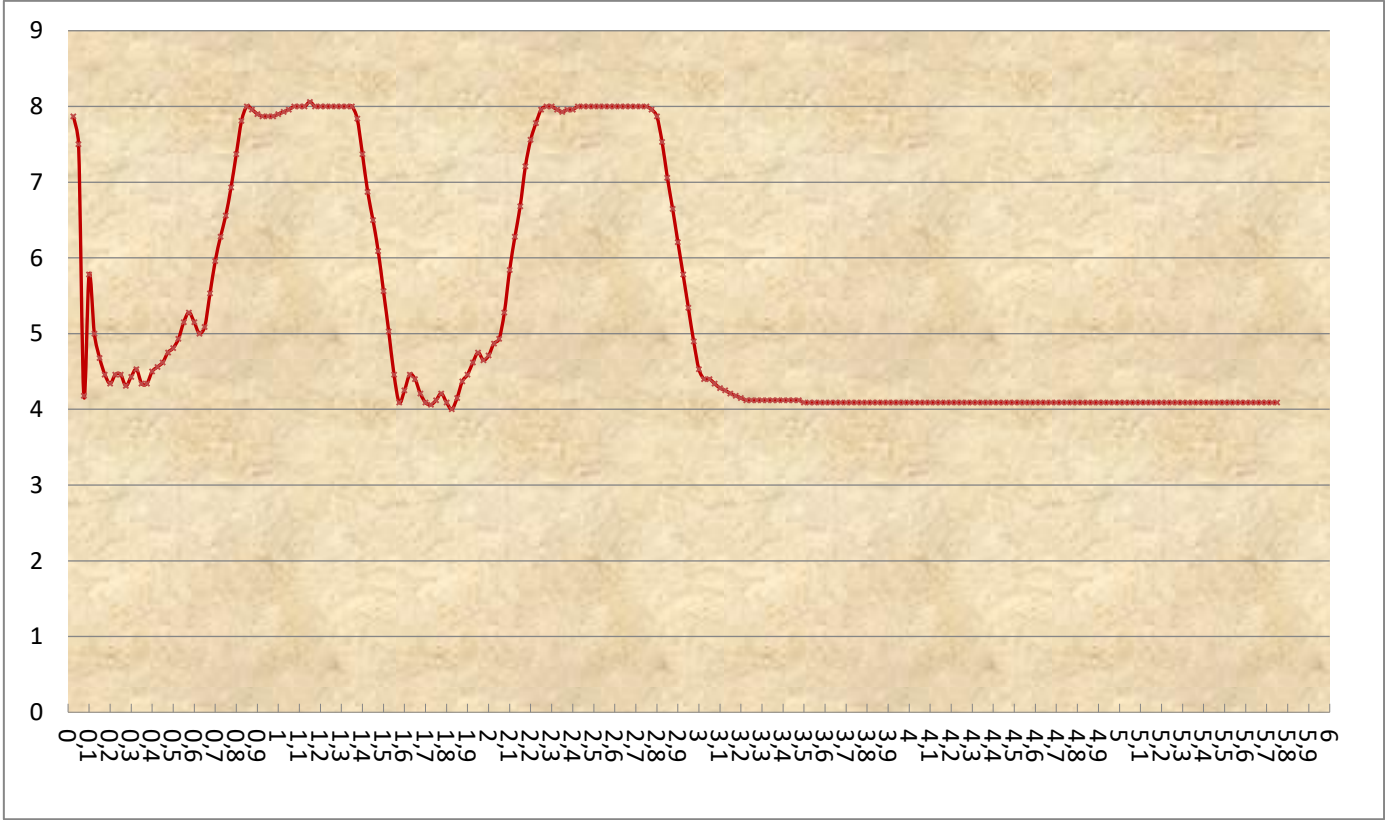

Visa: