



FICHE DE CONTRÔLE ARI

N° d'essai :

Effectué le :

28/10/2025

Nom:

GINET

Table de paramètres:


3

Fonction:

Technicien S

	Type d'appareil : Numéro de Chassis: Numéro de régulateur: Numéro de détendeur: Numéro de masque:	GPAL QS CQS22214-SAL013 RC20960 DIS2320078 T3C/74275	Nature: Fabriqué en:	S janv-24																				
Etanchéité masque Résultat: Correct	Valeur début test: Valeur fin test: Remarques:	-6.9 mb -6.9 mb SRARIMASDRAGE-SAL412	Pente fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	6 mb/mn -0 mb/mn																				
Manomètre Résultat: Correct	Consignes Mesures Remarques:	<table><thead><tr><th></th><th>Mesures</th><th>Tolérance haute</th><th>Tolérance basse</th><th>Saisie opérateur</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>217 b</td><td>10 b</td><td>10 b</td><td>216 b</td></tr><tr><td></td><td>130 b</td><td>10 b</td><td>10 b</td><td>131 b</td></tr><tr><td></td><td>70 b</td><td>5 b</td><td>5 b</td><td>70 b</td></tr></tbody></table> SRARIDOS-QS-SAL013		Mesures	Tolérance haute	Tolérance basse	Saisie opérateur		217 b	10 b	10 b	216 b		130 b	10 b	10 b	131 b		70 b	5 b	5 b	70 b		
	Mesures	Tolérance haute	Tolérance basse	Saisie opérateur																				
	217 b	10 b	10 b	216 b																				
	130 b	10 b	10 b	131 b																				
	70 b	5 b	5 b	70 b																				
Moyenne pression Résultat: Correct	Seuil référence: Valeur MP+10s:	7 b 6.7 b	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	1 b 1 b																				
Etanchéité détendeur Résultat: Correct	Valeur MP+20s: Remarque:	6.7 b SRARIDOS-QS-SAL013	Pente de fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	1.5 b/mn 0 b/mn																				
Sifflet manuel Résultat: Correct	Seuil Référence: Valeur mesurée: Remarque:	55 b 54 b SRARIDOS-QS-SAL013	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	5 b 5 b																				
Soupape de sécurité Résultat: Correct	Seuil Référence: Valeur mesurée: Remarque:	9 b 10.7 b SRARIDOS-QS-SAL013	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	0 b 4 b																				

Controle				
dynamique	Fréquence respiratoire:	40 Cps/mn	Volume:	2.5 Litres
	Valeur BP stat mesurée:	3.8 mb	Tolérance basse référen:	2 mb
			Tolérance haute référen:	4 mb
Résultat BP:	ValeurminiMP mesurée:	6 b	Mini MP Référence:	4.5 b
Correct	ValeurmaxBP mesurée:	7.975 mb	SHR Référence:	10 mb
	ValeurminiBP mesurée:	2.20625 mb	SBR Référence:	0.5 mb
Résultat MP:	Remarque :			
Correct				

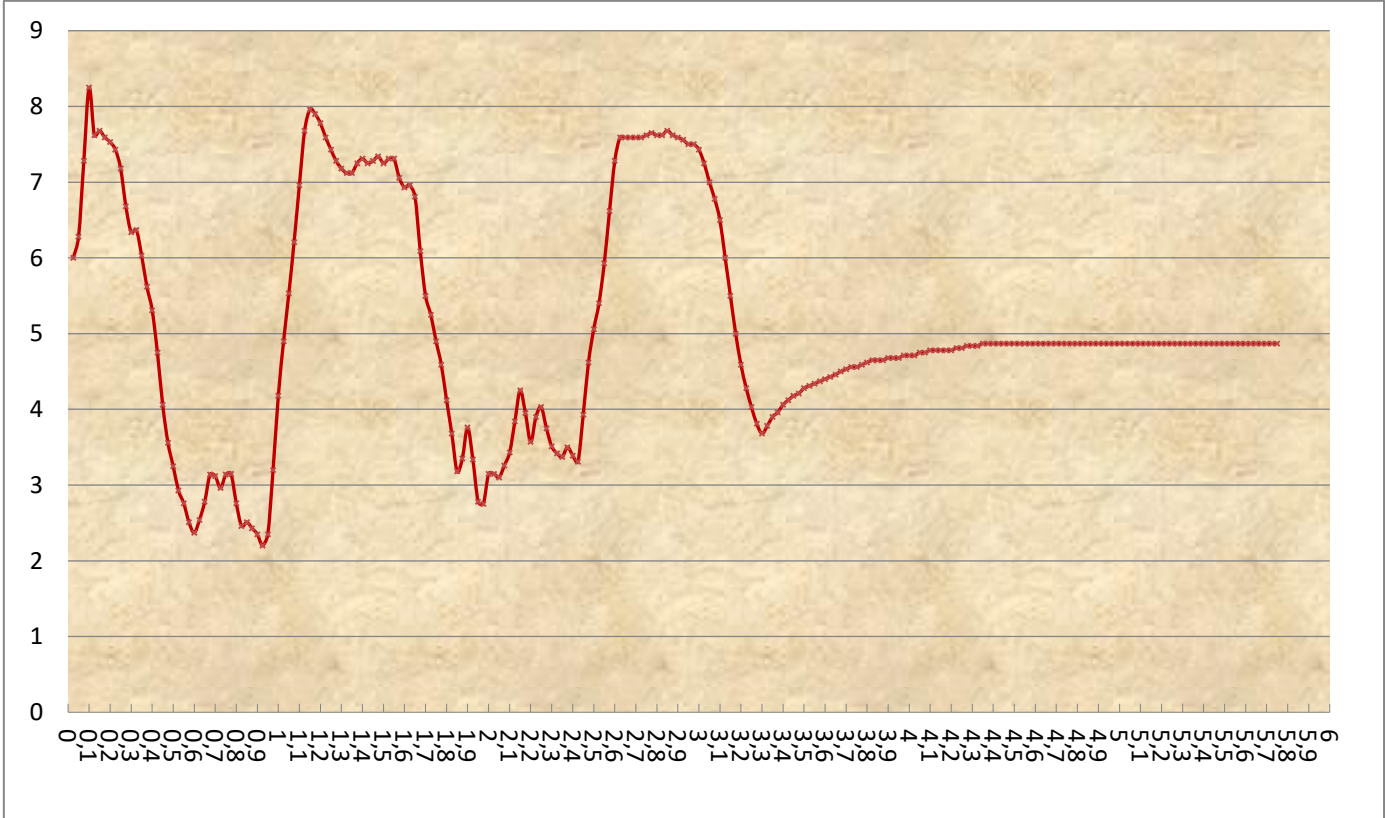

Visa: