




<b>Controle dynamique</b>	Fréquence respiratoire:	Volume:
	Valeur BP stat mesurée:	Tolérance basse référen:
Résultat BP:	ValeurminiMP mesurée:	Tolérance haute référen:
	ValeurmaxBP mesurée:	Mini MP Référence:
	ValeurminiBP mesurée:	SHR Référence:
Résultat MP:	Remarque :	SBR Référence:



**Visa:**

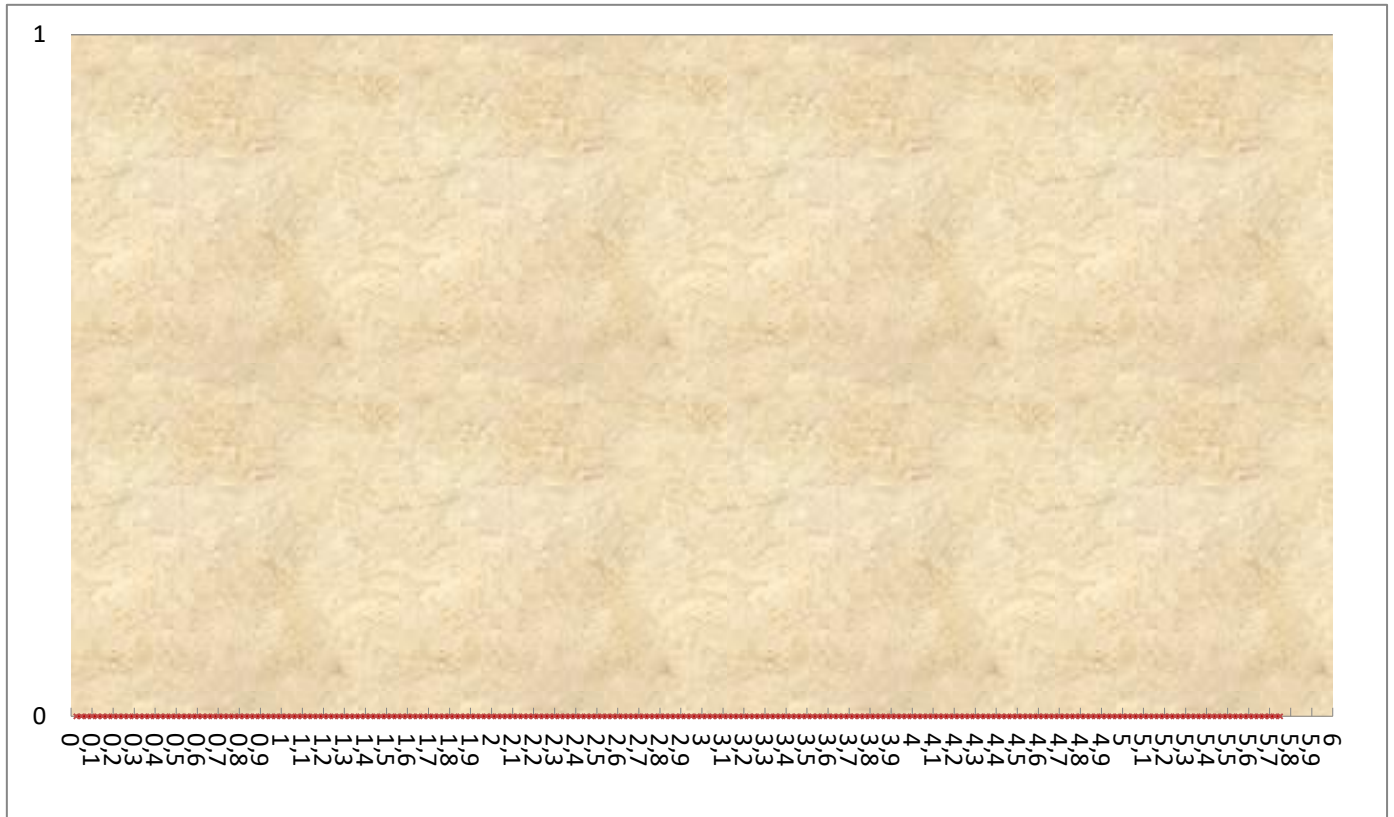